


# **CT-DECT Multi WireCom – Digitális Interfész Bázisállomás**

**CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész  
bázisállomás adóvevőeszköz integrált WireCom-  
elektronikával és opcionális kódolással**  
Kezelési útmutató

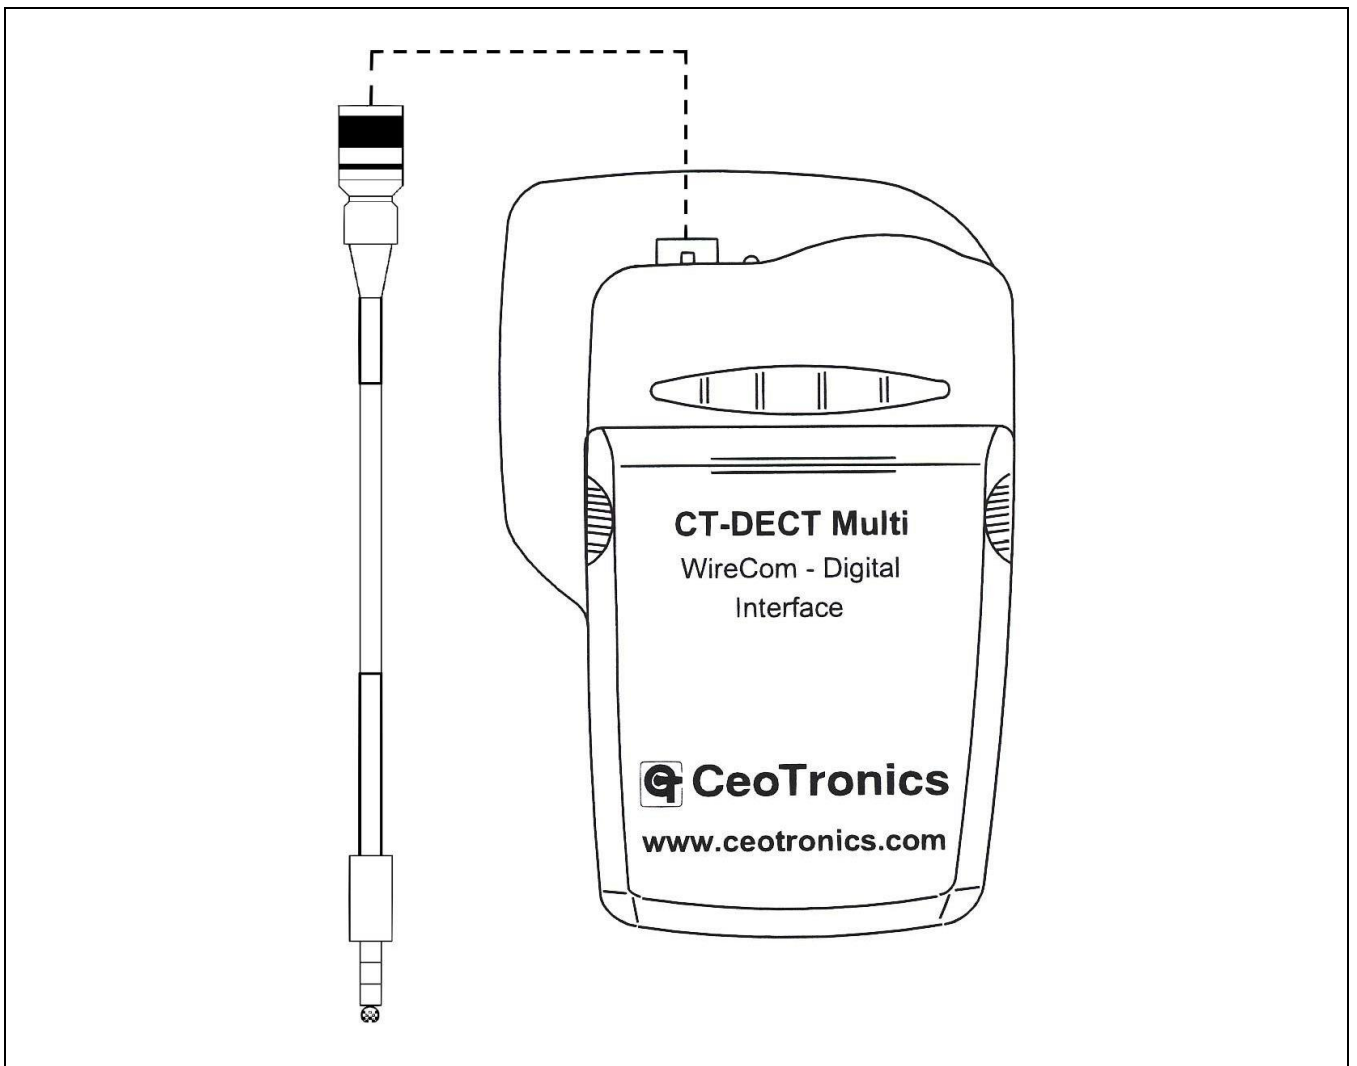

**Magyar**

---

## Tartalom

1.	Fontos biztonsági megjegyzések .....	3
2.	Leírás.....	6
2.1	Általános.....	6
2.2	Áramellátás.....	6
2.3	PTT-kritérium .....	6
3.	Üzembe helyezés és üzemeltetés.....	8
4.	A hatósugár túllépése .....	8
5.	Tárolás – raktározás .....	8
6.	Karbantartás .....	9
6.1	Szemrevételezés .....	9
6.2	Tisztítás .....	9
7.	A CT-DECT Headset Standard készülékek betanítása a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson.....	10
7.1	Általános.....	10
7.2	A betanítás alapelvei.....	10
7.3	Betanítás .....	11
7.4	A betanítás után.....	11

## 1. Fontos biztonsági megjegyzések



**A készülék használata során a dologi károk és személyi sérülések megelőzése érdekében kövesse a nemzeti biztonsági és balesetmegelőzési előírásokat, illetve a jelen dokumentumban található figyelmeztetéseket és biztonsági tudnivalókat.**

- Mielőtt használatba venné a CeoTronics-termékeit, kérjük gondosan olvassa el a vonatkozó használati útmutatót. Amennyiben kétségei merülnének fel, forduljon bizalommal szakképzett munkatársainkhoz.
- Kérjük, őrizze meg a jelen dokumentumot későbbi konzultáció céljából.
- A CeoTronics-termékek csak sértetlen, kopásmentes állapotban használhatók.
- A CeoTronics-termékek karbantartási munkálatait csak a CeoTronics-nál, vagy a CeoTronics által minősített szakműhelyben végeztesse el. Minden más esetben megszűnik a termékre vállalt jótállási és szavatossági kötelezettség.
- A CeoTronics-termékeket tartsa távol gyerekektől, illetve olyan személyektől, akik nem jártasak kezelésükben.
- A CeoTronics-termékek csak a speciális rendeltetésüknek megfelelő esetekben alkalmazhatók.
- A biztonságos üzemeltetéshez tartsa tisztán a készülékeket. Gondoskodjon arról, hogy a készülékek mindig tiszták és megfelelő állapotban legyenek.
- Azokat a termékeket, amelyeket a CeoTronics Önnek leszállított, és amelyeket végleg ki kell vonni a forgalomból, a CeoTronics visszaveszi. Mi ezeket az eszközöket újrahasznosítjuk, vagy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítjuk.



### Készülékkár!

- Ne merítsen CeoTronics-terméket vízbe, csak ha erre a célra lett kialakítva.
- A CeoTronics-tartozékokat csak kikapcsolt állapotban szabad a készülékhez csatlakoztatni vagy arról leválasztani, amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz ettől eltérő információt.
- A szabadban történő felhasználásra tervezett készülékeket a szabadban történő használat során mindig hagyja lezárva (pl. CT-DECT Case), és a használaton kívüli csatlakozásokat mindig zárja le az erre szolgáló lezárókkal – amennyiben rendelkezésre állnak.
- A CeoTronics-termékeket ne tárolja szabadban vagy nedves, nyirkos környezetben, hanem tartsa azokat mindig tiszta, száraz, normál páratartalmú helyen. A CeoTronics-termékeket nem szabad +80°C-nál magasabb hőmérsékleten, pl. nyáron az autó kalaptartóján tárolni. Amennyiben a terméken nincs másként megjelölve, a CeoTronics-termékeknél a következő hőmérséklet-tartományok megengedettek: Üzemi hőmérséklet: -10°C - +55°C, tárolási hőmérséklet: -40°C - +80°C.
- Az eszköz tisztításakor ügyeljen arra, hogy a belső részbe ne kerüljön víz. A tisztításhoz ne használjon oldószereket (pl. benzin, alkohol, stb.)! A biztonságos üzemeltetéshez tartsa tisztán a készülékeket. Gondoskodjon arról, hogy a készülékek (mikrofonok, csatlakozók stb.) mindig tiszták és megfelelő állapotban legyenek.

### Sérülésveszély a csatlakozó vezetékek miatt!

- Ügyeljen arra a csatlakozókábelekkel felszerelt CeoTronics-termékek használata során, hogy a vezeték ne akadhaszon járó gépezetbe vagy kerekekbe!

### Sérülésveszély a fejhallgató hangereje miatt!

- Ügyeljen arra, hogy egyes audio-berendezések (pl. rádiók) esetében a bekapcsoláskor extrém hangerejű hangjelzések léphetnek fel. *Vannak készülékek, amelyek mindig eltérő hangerősségű hangjelzéseket adnak le. Előfordulhat, hogy a különböző hangerejű hangjelzéseket külön kell beállítani. Ezek a hangok – ha túl hangosra állítják azokat – halláskárosodáshoz vezethetnek. Ezért a CeoTronics tartozékok használata előtt mindig állítsa a hangjelzéseket a szükséges hangerőre. A hangjelzések beállításával kapcsolatosan kövesse az audiokészülék használati útmutatóját.*
- Biztonsági okokból több CeoTronics-termék esetében a vételi hangerő 85 dB(A) felett lehetséges, ez azonban a termék felhasználója által szabályozható. Miután bekapcsolta a kommunikációs eszközt,

---

állítsa a vételi hangerőt körülbelül a rendelkezésre álló hangerőtartomány felére, majd ellenőrizze a hangerőt, például úgy, hogy kinyitja a rádiós készüléken található zajsűrőt.

- Ne állítsa a szükségesnél erősebbre a hangerőt. A túl magas hangerők, főleg állandó üzemeltetés mellett, károsíthatják a hallást. Nagy hangerő vagy fokozott zajszint esetén viseljen fülvédő dugót. Amennyiben kétségei merülnének fel, forduljon a biztonsági felelőshöz vagy az üzemorvoshoz.

#### **A közúti közlekedés befolyásolása!**

- Ne hagyjon CeoTronics-termékeket szabadon az autóban, pl. a kalaptartón. Tegye a termékeket az autóban egy megfelelő, biztonságos helyre, hogy pl. nagy erejű fékezéskor ne veszélyeztesse Önt vagy utasát.
- Ha autót vezet, ne használja a rádió üzemmódot, mert az elvonhatja figyelmét a forgalomról, valamint soha ne használjon sofőrként olyan CeoTronics-terméket (headset, fülhallgató, indukciós vevőkészülék stb.), ami a hallást korlátozza.

#### **A légi közlekedés befolyásolása!**

- Mindig hagyja az adó-/vevőkészüléket kikapcsolva, ha repülőgép fedélzetén tartózkodik. Az adó-/vevőkészülék üzemeltetése befolyásolhatja a légi közlekedést, ezért tilos. Soha ne vegye használatba a készüléket repülőgép fedélzetén az illetékes fedélzeti személyzet kifejezett hozzájárulása nélkül.
- Az intercom-kapcsolat befejezését követően távolítsa el a készüléket a repülőgépről. A "REMOVE BEFORE FLIGHT" jelzésű figyelmeztetést soha nem szabad a CT-DECT GateCom Compact készülékről eltávolítani.

#### **A rádiókommunikáció befolyásolása!**

- Csak akkor adjon, ha szükséges. A csatorna szükségtelen lefoglalása megakadályozhatja létfontosságú információk továbbítását.

#### **Robbanásveszély!**

- Azokat a CeoTronics-termékeket, amelyek nem gyújtószikramentesek (nem rendelkeznek Ex védelemmel) és nincsenek speciális Ex jelzéssel ellátva, soha nem szabad robbanásveszélyes környezetben üzemeltetni (pl. járművek, repülőgépek tankolásakor stb.). A védelmi rendszerrel nem rendelkező eszközök ilyen területeken robbanást idézhetnek elő!

#### **Elektromos áramütés miatti veszély!**

- Hálózatról üzemeltetett termékek esetében a kinyitás (pl. szervizelés miatt) előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból!
- A CeoTronics-termékeket kizárólag sértetlen állapotban használja. Bármilyen sérülés esetén a CeoTronics-terméket nem szabad tovább használni, hanem meg kell javíttatni.

#### **Pacemakerek befolyásolása!**

- Amennyiben pacemakert használ, tájékozódjon az adó-/vevőkészülék használatba vétele előtt a pacemaker gyártójánál a magas frekvencia általi esetleges befolyásolással kapcsolatosan.

#### **Akkumulátorok és elemek!**

- A használat után az elemeket a törvényhozó által előírt módon adja le díjtalanul egy kereskedésben, helyi gyűjtőponton vagy a CeoTronics-nál. Vegye figyelembe az elemrendeletet (BattV).



#### **Akkumulátorok és elemek miatti sérülésveszély!**

- Az akkumulátort csak akkor helyezze be, ha az összes biztonsági tudnivalót elolvasta és megértette. Egy akkumulátor potenciális veszélyeket hordoz, amelyek személyi sérülésekhez és/vagy dologi károkhoz vezethetnek.
- Soha ne próbálja meg kinyitni az akkumulátort, és ne dobja az akkumulátort a tűzbe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezéseknél és az akkumulátor töltőaljzatoknál ne alakuljon ki rövidzárlat

---

(tűz- és sérülésveszély) áthidalás miatt (pl. szétnyitott iratkapocs, kulcs vagy hasonló). Ebben az esetben a jótállás érvényét veszíti.

- A tartalék akkumulátorokat elektromosan nem vezető csomagolásban szállítsa a rövidzárlatok elkerülése érdekében.
- Az akkumulátorokat tartsa olyan személyektől távol, akik nem jártasak azok kezelésében (pl. többek között gyermekektől).
- Az akkumulátorok robbanásveszélyes területen történő töltése tilos – robbanásveszély! Az akkumulátorokat csak olyan területen töltsen és cserélje, ahol nem fordulhatnak elő együttesen robbanékony gázok, gőzök vagy porok és levegő.

#### **Töltő vagy akkumulátor károk!**

- Az akkumulátorokat csak a hozzájuk tartozó, megfelelő CeoTronics-töltővel töltsen. Ügyeljen a feszültség- és áramadatokra a hálózati oldalon is (pl. 230 V AC vagy 115 V AC).
- Soha ne használja az akkumulátor töltőt nem újratölthető elemek töltéséhez.
- A töltőberendezések sem víz-, sem porállóak, és védeni kell azokat a víztől, az esőtől és a szennyeződésektől. Csak beltérben, normál páratartalom és normál szobahőmérséklet mellett üzemeltethetők. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni.
- Az akkumulátorokat ne töltsen a szabadban.

#### **Rádiókészülék szoftver – téves funkciók veszélye!**

Ne feledje, hogy a rádiókészülék tartozékainak funkciói függhetnek a rádiókészülék szoftver-verziójától és a szoftver beállításaitól. A szoftverfrissítések és/vagy a szoftverbeállítások módosításai során óvatosan járjon el. Amennyiben szoftverfrissítéseket és/vagy szoftverbeállítás módosításokat kíván végrehajtani, először ellenőrizze egy rádiókészüléken, hogy a rádiókészülék tartozékok a módosítást követően hibátlanul működnek-e.

Egyes rádiókészülékek esetében előfordulhat, hogy a vételi hangerő nem kielégítő. Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a rádiókészülék audioprofiljának paraméterein keresztül történő hangerő emelés lehetőségét.

Amennyiben a témával kapcsolatosan kérdései vannak, kérjük, forduljon vevőtanácsadóinkhoz.

#### **Fontos tudnivalók a CT-DECT adó-/vevőkészülékekkel kapcsolatosan!**

- **Jogi tudnivalók az Európai Unióban történő üzemeltetés esetén**

A CT-DECT készülék adóegységét az Európai Unió területén csak akkor szabad használni, ha a következő jelöléssel rendelkezik:



- **Jogi tudnivalók az Egyesült Államokban történő üzemeltetés esetén**

A CT-DECT készülék adóegységét az Egyesült Államok területén csak akkor szabad használni, ha a következő jelöléssel rendelkezik:



- **Jogi tudnivalók Kanadában történő üzemeltetés esetén**

A CT-DECT készülék adóegységét Kanada területén csak akkor szabad használni, ha a következő jelöléssel rendelkezik:



## **Szakszerűtlen használat!**

*A CeoTronics-termékek speciális feladatokhoz, pl. robbanásveszélyes területen, légitölekedésben, bombahatástalanítás stb. területen történő használata esetén kizárólagosan az üzemeltető felelős azért, hogy ellenőrizze és megállapítsa, hogy a termékek veszélytelenül üzemeltethetők-e.*

*A CeoTronics nem vállal felelősséget a dologi károkért és személyi sérülésekért, amelyek a fent leírt vagy más szakszerűtlen használatra vezethetők vissza.*

## **2. Leírás**

### **2.1 Általános**

A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás adóvevőeszköz egy kis hatósugarú kommunikációs rendszer része, mely lehetővé teszi a "mobil", CT-DECT Headset Standarddal rendelkező kommunikációs résztvevők és a vezetékes WireCom rendszerek használói közötti kommunikációt. A CT-DECT Headsettel rendelkező "mobil" kommunikációs résztvevők közötti kommunikáció vezeték nélkül történik.

A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás egy max. négy CT-DECT Headset Standard kiszolgálására alkalmas bázisállomás, melyet a mellékelt adapterkábelrel csatlakoztatnak a WireCom rendszer gyűrűvezetékéhez. A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás tartalmazza a WireCom rendszer CT-DECT rendszerhez való igazításához szükséges elektronikát.

A CT-DECT Headset Standard készülékeket általában csak a hozzájuk rendelt CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomásokkal használják, amelyre be lettek tanítva. Egy CT-DECT Headset Standard CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomással együtt csak akkor használható, ha a CT-DECT Headset Standardot betanították a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson.

### **➔ TUDNIVALÓK az opcionális kódolással kapcsolatban**

***A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás (jelölés "S-7.5.41") rendelkezik kódolással. Ez azt jelenti, hogy csak az ilyen kódolást támogató CT-DECT Headset Standard (jelölés "S.-7.5.42") készülékek használhatók, amelyek tudnak kommunikálni a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomással.***

A CT-DECT készülékek közötti hatótávolság (bázis/FP és Standard/PP) a helyi adottságoktól függ. A legnagyobb hatótávolságot szabad területen, látási feltételek között éri el. A környezeti befolyásoló tényezők, például hegyek, épületek, fák, időjárás, akadályok (különösen fémes) és a testtompítás személyen viselt eszközök esetén korlátozhatják a hatótávolságot. A hatókör elhagyása esetén a headset viselője akusztikus figyelmeztetésben részesül.


### **2.2 Áramellátás**

A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás áramellátását a WireCom rendszer biztosítja, amint a Multit csatlakoztatják az adapterkábel segítségével a WireCom rendszer gyűrűvezetékéhez. A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás nem rendelkezik ki-/bekapcsolóval. Amennyiben a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás áramellátást kap, akkor az 1/e. ábrán látható LED zölden világít.

### **2.3 PTT-kritérium**

A CT-DECT Headset Standardon található opcionális PTT-gombbal a "mobil" kommunikációs résztvevő PTT-kritériumot (PTT = push to talk) küldhet a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomásnak, amely csatlakoztatva van a WireCom rendszer gyűrűvezetékéhez. Ezzel a PTT-követelménnyel a PTT-gomb nyomvatartása közben távvezérelhető egy rádiótávbeszélő, amely csatlakoztatva van a WireCom rendszerhez.

1. ábra Kezelő- és csatlakozóelemek

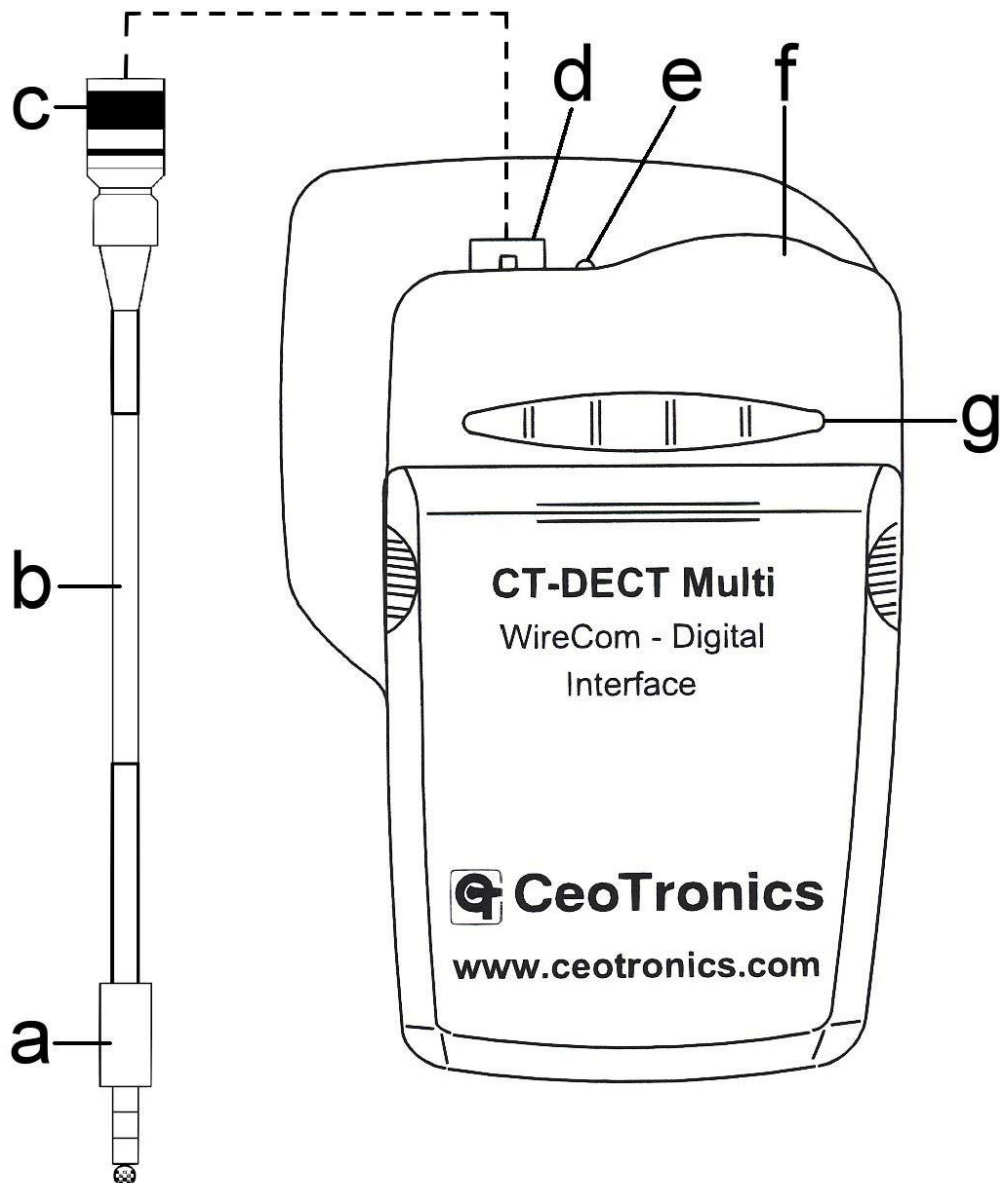

- a Cinch-csatlakozó "Nexus TP120" a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás WireCom rendszer gyűrűvezetékéhez történő csatlakoztatásához
- b Adapterkábel, kb. 40 cm hosszú (csatlakozókkal)
- c 6-pólusú "Hirose" csatlakozó az adapterkábel CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáshoz történő csatlakoztatásához
- d 6-pólusú "Hirose" aljzat az adapterkábel csatlakoztatásához
- e Státuszjelző LED (zöld – üzemkész / piros – betanítás folyamatban)
- f CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás
- g Gombsor 5 gombbal  
Mind az 5 gomb használható a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás betanításához (lásd 7...7.4 fejezetek).

---

### 3. Üzembe helyezés és üzemeltetés

#### a. CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás

Amennyiben még nem történt meg, csatlakoztassa az adapterkábel a 6-pólusú csatlakozó (1/c. ábra) segítségével a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás 6-pólusú aljzatához (1/d. ábra).

Csatlakoztassa a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomást a cinch-csatlakozóval (1/a. ábra) a WireCom rendszer gyűrűvezetékéhez.

Ezzel a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás üzemkész, mivel az áramellátást a WireCom rendszer gyűrűvezetéke biztosítja. Az 1/e. ábra LED-je zölden világít. A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás nem rendelkezik ki-/bekapcsolóval.

#### ➔ FONTOS

**Védje a készüléket a nedvességtől.**

#### b. Max. négy CT-DECT Headset Standard

Vegye fel a headsetet, és állítsa be úgy, hogy a viselése kényelmes legyen.

Vegye figyelembe a CT-DECT Headset beüzemelése és üzemeltetése során a CeoTronics használati utasításában foglaltakat.

#### ➔ FONTOS

**A CT-DECT Headset Standard készülékeket be kell tanítani a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson. (lásd 7...7.4. fejezetek).**

Kapcsolja be a CT-DECT Headseteket.

Ezt követően megkezdődik az automatikus kapcsolódás a CT-DECT Headsetek és a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás között, ami helyzetenként eltérő időt vehet igénybe. Néhány másodperc elteltével a CT-DECT Headset kettős hangjelzéssel hívja fel a figyelmet a CT-DECT Headset és a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás közötti szinkronizáció létrejöttére. A kapcsolat létrejöttékor a CT-DECT Headsetekben egy magas hangjelzés hallható. A CT-DECT Headsetek és a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás készen áll a duplex kommunikációra a CT-DECT Headsetek és a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás hatótávolságán belül.

#### c. Kommunikáció

A kapcsolat automatikus felépítése után a CT-DECT Headseteket használó mobil kommunikációs résztvevők tartósan tudnak kommunikálni egymással. A headset mikrofonján keresztül minden résztvevő beszélni tud, a headset fülhallgatóján keresztül pedig hallja a többi résztvevő beszédét (duplex kommunikáció). A beszédhez a headset mikrofonjának bekapcsolt állapotban kell lennie. A WireCom rendszer és a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás által fogadott közleményeket minden résztvevő hallja.

A WireCom rendszerhez csatlakoztatott kommunikációs résztvevők mindig hallják a CT-DECT Headsetet használó mobil résztvevők beszédét, és bármikor tudnak beszélni a mobil résztvevőkkel.

### 4. A hatósugár túllépése

A hatósugár túllépése esetén a CT-DECT Headset és a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás közötti kapcsolat megszakad. Amennyiben a CT-DECT Headset viselője visszatér a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás hatókörébe, akkor a kapcsolat automatikusan újra létrejön. A CT-DECT Headsetben először egy magas dupla hangjelzés hallható, majd egy magas hangjelzés jelzi, hogy a kapcsolat létrejött.

### 5. Tárolás – raktározás

A megtisztított készüléket tiszta, száraz helyen, szobahőmérsékleten és normál páratartalom mellett tárolja.



---

## 6. Karbantartás

### 6.1 Szemrevételezés

Rendszeresen vizsgálja meg az eszközt, különösen törésre, szakadásra, kopásra. A meghibásodott készüléket küldje a CeoTronics-hoz javításra.

#### ➔ FONTOS

***A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás gyári helyreállítását követően a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomást újra be kell tanítani.*** A betanítással kapcsolatos további részleteket a 7. fejezet tartalmaz.

### 6.2 Tisztítás

A rátapadt port puha ecsettel távolítsa el. Tisztítsa meg a készüléket kívülről szükség szerint egy alkalmas, tiszta vízzel benedvesített, tiszta ronggyal, és ezt követően törölje szárazra azt. Erős szennyeződések esetén használjon egy kevés mosogatószeret. A csatlakozókat szokványos kontakt tisztítószerrel tisztítsa meg.

## 7. A CT-DECT Headset Standard készülékek betanítása a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson

### 7.1 Általános

#### ➔ TUDNIVALÓK

- A standard CT-DECT készülékek (PP) CT-DECT bázis (FP) készüléken történő betanítása általában csak egy CT-DECT rendszer első használatbavételekor, illetve egyes CT-DECT készülékek pl. javítás miatti cseréjekor szükséges.
- Egy CT-DECT standard (PP) készülék egyidejűleg mindig csak egy CT-DECT bázis (FP) készüléken tanítható be, kettő vagy több készüléken nem.
- A csomag tartalmától függően előfordulhat, hogy a CT-DECT készülékek már a CeoTronics-nál elvégzett minőségbiztosítási végellenőrzés során betanításra kerültek.  
Ebben az esetben a csomagban egy tájékoztató került elhelyezésre. Több CT-DECT bázis (FP) készülék esetén a CT-DECT készülékek megjelölése az egyes CT-DECT bázis (FP) készülékekhez történő hozzárendelés alapján történik.
- Nincs lehetőség arra, hogy egyszerre két CT-DECT standard (PP) készüléket tanítsanak be egy CT-DECT bázis (FP) készüléken; ez a művelet mindig csak egyesével hajtható végre.  
Több CT-DECT standard (PP) készülék esetén célszerű az összes, azonos készülékcsoporthoz tartozó készüléket egymás után betanítani a CT-DECT bázis (FP) készüléken, mivel ellenkező esetben előfordulhat, hogy egy készülék véletlenül törlésre kerül (lásd 8.1. rész "A betanítás elve").
- Tartsa be a kezelési lépések sorrendjét.
- Minden újonnan betanított készüléket a betanítást követően egyszer ki kell kapcsolni.


A betanítás a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson és max. négy CT-DECT Headset Standardon, a kezelőelemek használatával történik. A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás az a készülék, amelyen a CT-DECT Headset Standardok betanításra kerülnek.

### 7.2 A betanítás alapelvei

Mindegyik készülék rendelkezik CT-DECT-modullal, illetve saját azonosítószámmal. Először mindig a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás és max. négy CT-DECT Headset Standard között kell kialakítani az összerendelést. Ezt az egyszeri betanítási folyamatot (subscription) a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson és a CT-DECT Headset Standardon manuálisan, a kezelési eljárás részeként kell végrehajtani.

Egy ötödik CT-DECT Headset Standard CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson történő betanítása esetén az első CT-DECT Headset Standard törlésre kerül a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás adattárolójából. Lásd az alábbi példát.

A betanítási elve (példa)

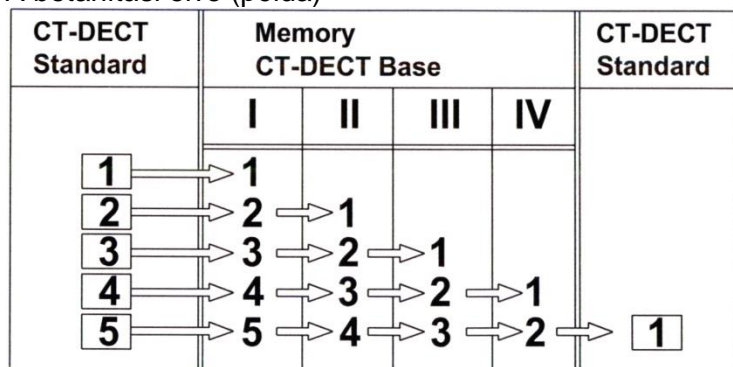

A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás adatbázisából törölt CT-DECT Headset Standard a továbbiakban nem tud kommunikálni a rendszerrel, és a használati útmutatóban foglaltak alapján újra be kell tanítani azt a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson.

---

A betanítási folyamat sikeres lezárása esetén a bejelentkezett kommunikációs partner azonosítója eltárolásra kerül a készülék memóriájában. Egy CT-DECT Headset Standard készülékeket egy CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson lehet betanítani. A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás a négy legutóbbi, sikeresen betanított CT-DECT Headset Standardot tárolja.

### **Időtűllépés**

Amennyiben legfeljebb 2 percen keresztül nem sikerül befejezni a betanítást, akkor "időtűllépés" történik. Az "időtűllépés"-t a CT-DECT Headsetben elhangzó négy mély hangjelzés jelzi, amely 4 másodpercenként ismétlődik.

"Időtűllépés" esetén minden szükséges CT-DECT Headset Standardot újra be kell tanítani a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson.

## **7.3 Betanítás**

A következőkben egy CT-DECT Headset Standard CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson történő betanítása kerül leírásra. A második, illetve harmadik és negyedik CT-DECT Headset Standard CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomáson történő betanítását értelemszerűen kell elvégezni.

- a. A CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás ne legyen csatlakoztatva a WireCom rendszer gyűrűvezetékéhez (áramellátás). Csatlakoztassa az adapterkábel (1/b. ábra) a Multihoz. Győződjön meg arról, hogy a betanítani kívánt CT-DECT Headset Standard ki van kapcsolva. Húzza le a kagylóburkolatot a headset bal kagylójáról. A headset kagylógyűrűjében található a betanító gomb. Kövesse a headsetre vonatkozó CeoTronics használati útmutatót.
- b. Nyomja meg a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás öt gombjának legalább egyikét a gombsoron (1/g. ábra), és tartsa lenyomva. A gomb nyomvatartása közben csatlakoztassa a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomást az adapterkábel cinch-csatlakozójával a WireCom rendszer gyűrűvezetékéhez, és tartsa a gombot ezt követően legalább addig lenyomva, amíg a LED (1/e. ábra) pirosan világítani kezd. Ezt követően folytassa a "c" lépéssel, hogy ne kerüljön sor "időtűllépésre".
- c. Nyomja meg a headseten a betanítás gombot, és tartsa lenyomva azt. A betanítás gomb nyomvatartása közben a ki-/bekapcsológombbal és a hangerőgombbal (tárcsa) kapcsolja be a headsetet, és a bekapcsolást követően legalább még 2 másodpercig tartsa megnyomva a betanítás gombot. Engedje fel a betanítás gombot.  
A betanítás elkezdődött, a headsetben kb. 2 másodpercenként egy rövid, magas csipogás hallható. Kb. 30 másodperc elteltével dupla, magas csipogó hang hallható. A betanítás sikeresen befejeződött.
- d. **A betanítást követően kapcsolja ki a betanított első headsetet. Húzza le a Multi-adapterkábel cinch-csatlakozóját a WireCom rendszer gyűrűvezetékéről, hogy leválassza a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomást az áramellátásról.**

## **7.4 A betanítás után**

A betanítást követően az újonnan betanított CT-DECT Headset Standard készülékeket újra ki kell kapcsolni, és a CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomást le kell választani a gyűrűvezetékéről (áramellátás), mielőtt a kommunikációs rendszert használatba lehetne venni (lásd 3. fejezet).



### **Konformitätsinformation**

Hiermit erklärt die CeoTronics AG, dass sich das Gerät „CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) befindet.

Weitere Informationen zur Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage von unserem Fachpersonal bei der CeoTronics AG, Rödermark, Deutschland.



### **Information of Conformity**

Hereby the CeoTronics AG declares, that the device „CT-DECT Multi WireCom – digitális interfész bázisállomás“ is in compliance with the essential requirements and the other relevant regulations of the directive 2014/53/EU (RED).

Further information regarding the Declaration of Conformity you can receive upon request from our specialized staff at CeoTronics AG Rödermark Germany.

**CeoTronics AG**  
Adam-Opel-Str. 6  
63322 Rödermark  
Tel. +49 6074 8751-0  
Fax +49 6074 8751-676  
E-Mail sales@ceotronics.com









**Certificate No. 01100004023 (ISO 9001)**

**Certificate No. 01220004023 (ATEX)**

**Deutschland und  
Internationaler Vertrieb**

CeoTronics AG  
Adam-Opel-Str. 6  
63322 Rödermark  
Tel. +49 6074 8751-0  
Fax +49 6074 8751-676  
E-Mail [verkauf@ceotronics.com](mailto:verkauf@ceotronics.com)

**Spanien**

**CeoTronics S.L.**  
C/Ciudad de Frias 7 y 9  
Nave 19  
28021 Madrid  
Tel. +34 91 4608250 51  
Fax +34 91 4603193  
E-Mail [ventas@ceotronics.es](mailto:ventas@ceotronics.es)

**USA/Kanada/Mexico**

**CeoTronics, Inc.**  
512 South Lynnhaven Road, Suite 104  
Virginia Beach, Virginia 23452  
Tel. +1 757 549-6220  
Fax +1 757 549-6240  
E-Mail [sales@ceotronicsusa.com](mailto:sales@ceotronicsusa.com)

**Deutschland und  
Internationaler Vertrieb**

**CT-Video GmbH**  
Gewerbegebiet Rothenschirmbach 9  
06295 Lutherstadt Eisleben  
Tel. +49 34776 6149-0  
Fax +49 34776 6149-11  
E-Mail [ctv.info@ceotronics.com](mailto:ctv.info@ceotronics.com)

Änderungen vorbehalten CeoTronics AG, 63322 Rödermark, Deutschland, **Internet** [www.ceotronics.com](http://www.ceotronics.com)